

# Новый отчет

Фирма


Заказчик

Контролер

Прибор testo 875-2


Серийный №: 2103479

Заказ

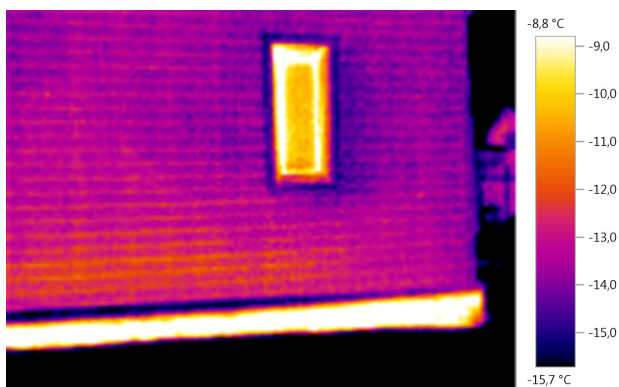


Графические данные: Дата: 19.02.2012  
Время: 10:43:17  
Файл: IV\_00044.BMT

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 25,0

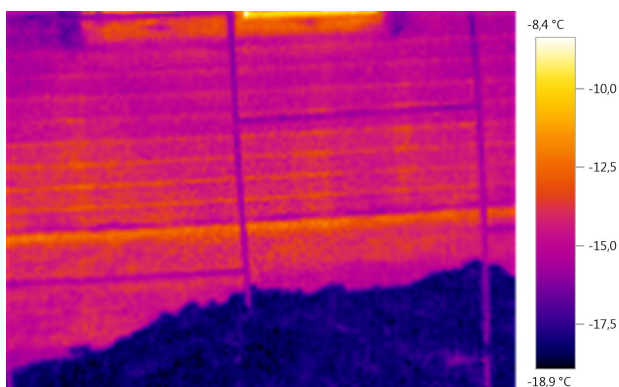



Графические данные: Дата: 19.02.2012  
Время: 10:37:21  
Файл: IV\_00037.BMT

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 25,0

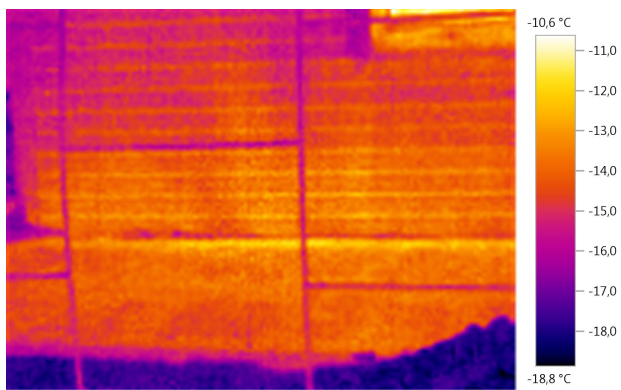


Графические данные: Дата: 19.02.2012  
Время: 10:37:31  
Файл: IV\_00038.BMT

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 25,0

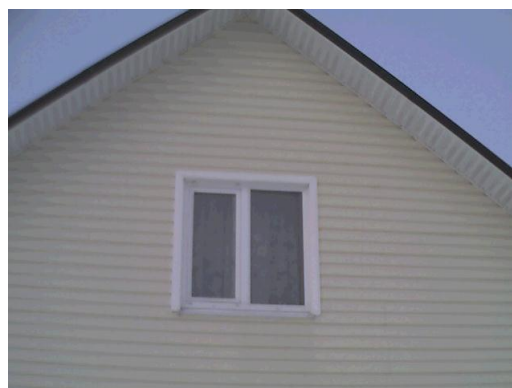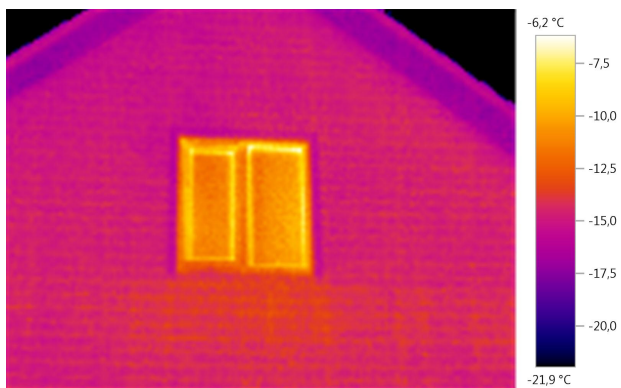


Графические данные: Дата: 19.02.2012  
Время: 10:40:08  
Файл: IV\_00043.BMT

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 25,0

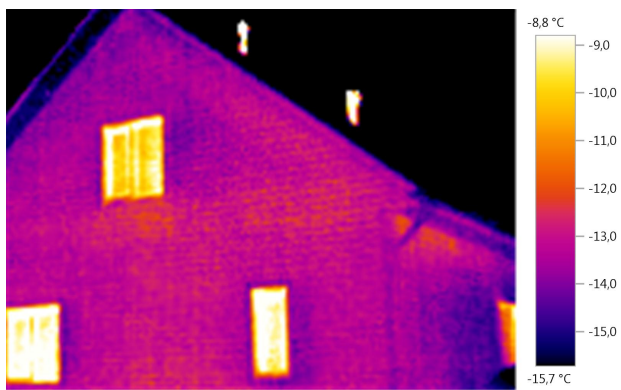


Графические данные: Дата: 19.02.2012  
Время: 10:43:48  
Файл: IV\_00045.BMT

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 25,0

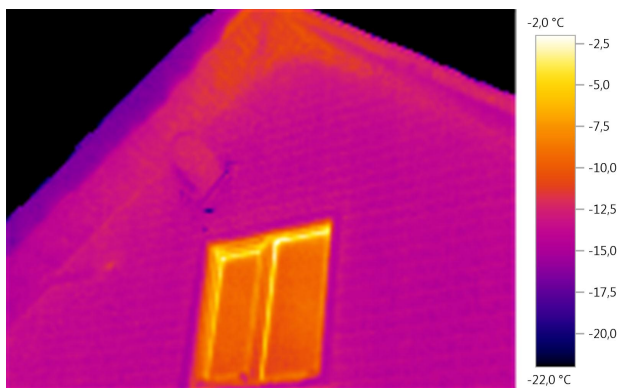

Графические данные: Дата: 19.02.2012  
Время: 10:49:46  
Файл: IV\_00056.BMT

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 25,0

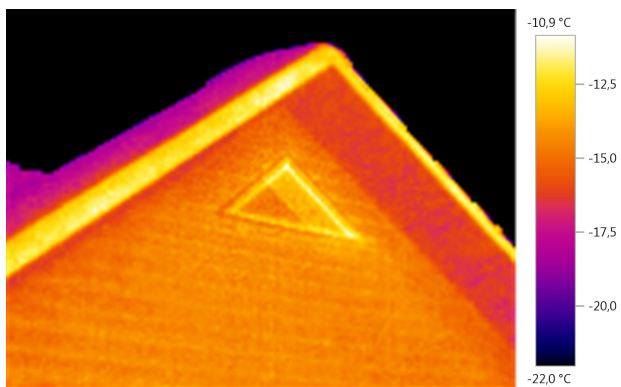

Графические данные: Дата: 19.02.2012  
Время: 10:50:56  
Файл: IV\_00060.BMT

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 25,0

21.02.2012 , \_\_\_\_\_